

Aanzetten NVS 103/104 1e consult


1. Voer een 'interrogation' uit.

- Selecteer vanuit het hoofdmenu 'Interrogate Device'.
- Plaats de 'wand' boven de pulse generator.
- Selecteer 'Start Interrogation'.
- Wacht tot de 'interrogation' is afgerond.



2. Pas de parameters aan


- Druk op 'New' achter de parameter die men wil aanpassen.
- Druk op de gewenste parameter instelling, gebruik de scroll toetsen voor meer parameter waarden. Annuleren kan door op 'Close' te drukken.
- Herhaal stap a. en b. voor elke parameter die men wil aanpassen.

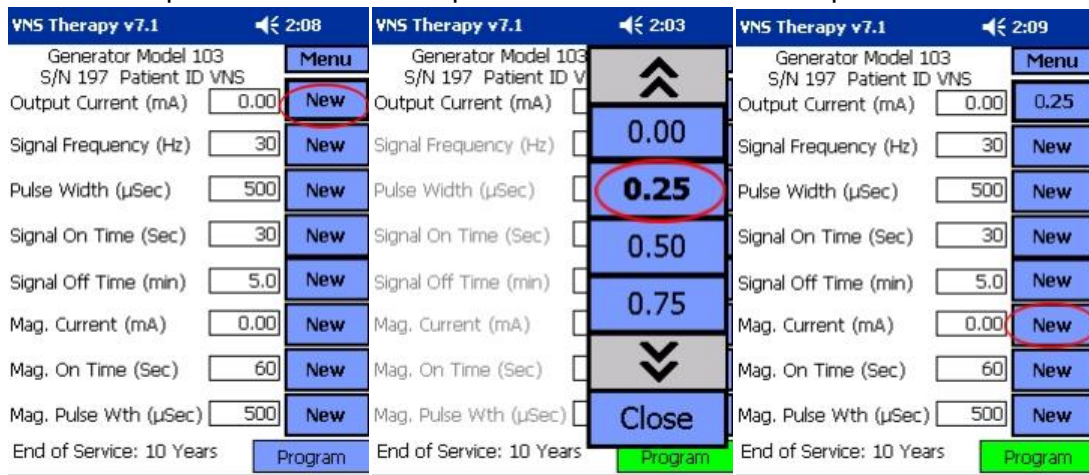

3. Programmeer gewenste parameters

- Dan selecteer ondertussen groen geworden '**Program**' toets.
- Toets vervolgens de '**Start Programming**' toets. De 'wand' dient nog goed gepositioneerd te zijn t.o.v. de pulse generator om de nieuwe parameters te kunnen programmeren. Wacht tot het programmeren is afgerond.

Vanaf dit moment zal de patiënt gestimuleerd worden zoals is ingesteld.

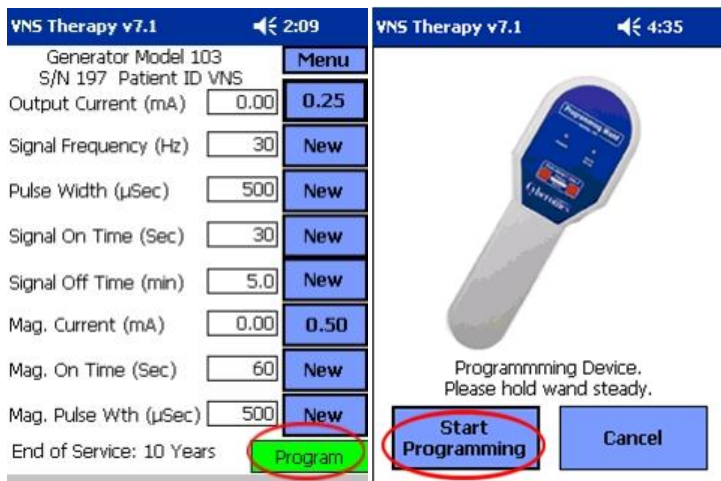

4. Controleer de instellingen

- Selecteer '**Menu**'.
- Selecteer '**Interrogate Device**'. Zorg hierbij dat de 'wand' nog goed is gepositioneerd t.o.v. de pulse generator.
- Wacht tot de '**interrogation**' is afgerond.
- Controleer parameters. Indien deze de gewenste waarden hebben. Selecteer '**Menu**' en '**Main Menu**'. De handheld kan nu worden uitgezet.